

## 校正報告

### CALIBRATION REPORT

Date : Apr. 12, 2023

第 1 頁 / 共 1 頁

Document number : **TP112C-04-1215**

客戶名稱 : 馬偕紀念醫院  
Customer name

產品名稱 : 溫濕度計  
Product name

型號 : DTM-303H  
Model No.

校驗人員 : 周碩恆  
Operator

校正項目 :  校驗  調整  
Cal. Info Cal.Only Adjusted

製造廠商 : TECPEL  
Manufacturer

序號 : TP213044  
Serial NO.

校驗日期 : Apr. 12, 2023  
Inspected date

建議再校日期 : Apr. 11, 2024  
Recommended Date

### 使用標準器 / TECPEL Standard

儀器型號 Model	儀器序號 ID. No.	追溯單位 Calibration sources	報告編號 Report No.	標準器校正日期 Calibration Date
TR-77Ui	F4080214	SGS	ECR2231299	Aug.23,2022

#### 1. Temperature Measurement Check (°C) :

	IN
Standard:	25.6
Reading:	26.4
Error	0.8

	OUT
Standard:	25.6
Reading:	25.8
Error	0.2

#### 2. Relative Humidity Measurement Check (RH%) :

Standard:	60.3
Reading:	56.8
Error	-3.5

Error = Reading - Standard

泰菱有限公司特此證明本報告內之受校儀器與標準器做過比較校正。

校正之標準器可追溯至中華民國度量衡國家標準實驗室標準。

上列的資料是以標準器進行比對測試所得的數據。本報告僅對送驗儀器之檢驗項目有效。

TECPEL certifies that equipment herein has been compared with the calibrated standards

The standards used to perform this calibration are traceable to NMI / ROC.

The above data shows the result of the comparison test with the standard instrument .

This inspection report is valid only to the items inspected.

泰菱有限公司

公司通訊地址: 新北市新店區民權路 130 巷 12 號 3 樓

電話: 02-2218-3111

傳真: 02- 2218-3222

報告簽署人

Signature

24354新北市泰山區明志路三段350號6樓

TEL: 886-2-8531-5388

FAX: 886-2-8531-5386

E-mail: hongu.co@msa.hinet.net

## 校正報告書

Calibration Report

Report No. HUS23071407

客戶名稱:	台北馬偕醫院臨床試驗藥局			連絡人:	陳泓伸藥師
電話:	(02)25433535 # 2243	申請日期:	2023/7/14	校正日期:	2023/7/14
受測儀器:	pHcbi 4°C 藥品冷藏櫃	型號:	MPR-1412	序號:	22100813
地址:	台北市中山北路二段92號B1				

## 使用標準器(Standards)

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacture	機型 Model
白金電阻溫度計	BRAIN CHILD	PR2012-OA211100

序號 Serial No.	追溯單位 Traceability	報告號碼 Report No	標準器有效日期 Due Date
219240017	TAF	LAT0170022	2023/12/1


實際環境 溫度: 21.6°C 相對濕度: 60%  
溫度檢查

溫度標準量測值(單位)	溫度實際讀值(單位)	誤差值(單位)
5.3°C	4.9°C	-0.4°C

附註: 1. 量測數值在允收誤差範圍 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以內。

2. 建議每一年做一次溫度測定及校正。

測量人員簽名

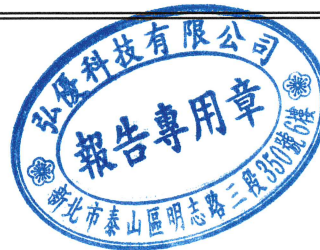

第一聯: 客戶留存聯

第二聯: 公司留存聯